

**Nasz znak: NZ/220/67/W1/2015**

**Data: 04.08.2015r.**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/67/2015 pn. dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:


### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

#### **Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2**

1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

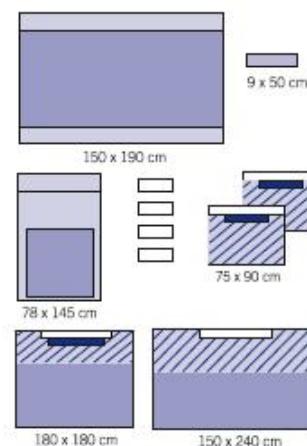

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny

Gramatura zgodna z wytycznymi w SIWZ

Chłonność w strefie krytycznej 512%

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 i 2**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli współczynnik normy odnoszący się do czystości w odniesieniu **do pyłów** (cząstek)? Zamawiający wpisał: „czystość w odniesieniu do płynów” – norma PN-EN 13795 nie obejmuje bowiem takiego badania w związku z czym nie istnieje dokument, który potwierdzi spełnianie tego parametru wedle w/w normy.

**Odp.: Zamawiający miał na myśli „czystość w odniesieniu do pyłów”.**



## ZESTAW 2

### PYTANIA DOTYCZA ZADANIA NR 3

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże z pakowaną niezależnie od zestawu jednokomorową kieszenią samoprzylepną w rozmiarze 43 x 38 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment opisany powyżej.**

2. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do cystoskopii, w którym w serwecie głównej wkomponowane są nogawice, o następującym składzie:



Zestaw do operacji urologicznych I	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment opisany powyżej.**

3. **Poz. nr 16-17-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki sterylnej spełniającej wymagania SIWZ, jednakże posiadającej przylepny otwór o średnicy 7cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment opisany powyżej.**

4. **Poz. 35** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga asortyment opisany powyżej.**

5. **Poz. nr 36-37-** prosimy o sprecyzowanie jakiego rozmiaru fartuchów oczekuje Zamawiający- M, L, XL, XXL?

**Odp.: Zamawiający wymaga fartuchów w rozmiarze: M, L, XL, XXL, przy czym wybór należy będzie do Zamawiającego.**

## ZESTAW 3

### 1. Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zgodne z SIWZ z minimum 2 szt. ręczników wykonanych z włókniny kompresowej, które są bezpieczniejsze do stosowania w warunkach bloku operacyjnego, gdyż są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz posiadają mniejszy wskaźnik pylenia w porównaniu do tradycyjnych ręczników celulozowych?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### 2. Zadanie nr 1, poz. 1 oraz zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające min. 2 etykiety zawierające datę ważności, nr katalogowy, nr serii i identyfikację producenta?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**3. Zadanie nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu minimum dwuwarstwowego, w którym warstwa zewnętrzna chłonna wykonana jest z włókniny polipropylenowej, druga warstwa (barierowa) - nieprzemakalna folia polietylenowo- polipropylenowa?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**4. Zadanie nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu minimum trójwarstwowego, w którym warstwa zewnętrzna chłonna wykonana jest z włókniny polipropylenowej, druga warstwa (barierowa) - nieprzemakalna folia polietylenowo- polipropylenowa, trzecia warstwa- włóknina wiskozowa?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**5. Zadanie nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą lepną o wym. min. 9cm x 50cm?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**6. Zadanie nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy zgodne z siwz z minimum 2 szt. ręczników wykonanych z włókniny kompresowej, które są bezpieczniejsze do stosowania w warunkach bloku operacyjnego, gdyż są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz posiadają mniejszy wskaźnik pylenia w porównaniu do tradycyjnych ręczników celulozowych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**7. Zadanie nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany bezpiecznie w jeden karton transportowy bez perforacji?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**8. Zadanie nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar podkładu 200x90cm lub 180cmx75cm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**9. Zadanie nr 7, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rozmiar podkładu 150cmx200cm lub 180x200cm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**10. Zadanie nr 7, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści koszulę operacyjną, która jest nieprzezierna, niepyląca i oddychająca typu SMS, z krótkim szerokim rękawem umożliwiającym dostęp do całej ręki, rozcięta od góry do dołu co umożliwia wygodniejsze zakładanie, podkrój szyi wykończony jest plisą, która jest jednocześnie wiązaniem, dodatkowo wiązana w pasie trokiem?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**11. Zadanie nr 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści pościel zgodną z SIWZ o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**12. Zadanie nr 7, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści ubranie operacyjne zgodne z SIWZ o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**13. Zadanie nr 7, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji podkład w rozmiarze 160cmx90cm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**14. Zadanie nr 7, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze min. 15cmx22cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga myjki opisane powyżej.**

**15. Zadanie nr 7, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści spodenki o długości spodni mierzonej po zewnętrznej linii nogawki równej 78cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**16.** Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: TAK, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku.**

**17.** Zważywszy na treść § 1 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp.: Zamawiający nie określi minimalnej ilości jaką zamówi na pewno.**

**18.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak podwyższyć ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy słowa „2% całej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 4**

##### **1. Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów krótkich z serwetą dolną o wymiarach 150 cm x 180 cm i z ręcznikami chłonnymi z włókniny, pozostałe składowe i parametry zestawu bez zmian?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

##### **2. Zadanie 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o grubości folii 0,035 mm i gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

##### **3. Zadanie 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na mikroskop o wym. 230 cm x 120 cm, średnica 65mm, bez możliwości dostosowania średnicy, osłona posiada paski samoprzylepne i z rzepami, które przytrzymują ją na właściwym miejscu.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

##### **4. Zadanie 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

##### **5. Zadanie 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

### **6. Zadanie 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Odp.: Zamawiający nie wydzieli poz. 2 z zadania 7.**

### **7. Zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> laminowany folią PE?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **8. Zadanie 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający odstąpi od podania parametru odporności na penetrację płynów?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **9. Zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

- Poszewka 70cm x 80cm
- Poszwa 160cm x 210cm
- Prześcieradło 150cm x 210cm

nie posiadająca właściwości antystatycznych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

### **10. Zadanie 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści myjkę-rękawicę o wym. 15 cm x 24 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **11. Zadanie 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści myjkę - ściereczkę o wym. 12 cm x 20 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **12. Zadanie 7, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści spodenki o długości nogawek 25-30 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **13. Zadanie 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści poszwę o wym. 160 cm x 210 cm gramaturze 25/m<sup>2</sup> z zakładką 15 cm bez zapięcia na rzep?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **14. Zadanie 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści poszwę bez zapięcia na rzep?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## **ZESTAW 5**

### **Zadanie nr 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet pakowanego w wentylowaną torbę foliową, która umożliwia łatwe i bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności asortymentu. Zestaw zawierający

stolik Mayo w rozmiarze minimum 75x140cm, wykonany z niebieskiej folii PE, w środkowej części wzmocniony warstwą chłonną z polipropylenu. Zestaw w pozostałym zakresie zgodny z wymogami SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

#### **Zadanie nr 5 poz.1, poz.2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu trójwarstwowego (Polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup>, o odporności na penetrację wody, płynów >20dmH<sub>2</sub>O, o wytrzymałości na rozrywanie i manipulację min.200kPa na mokro i sucho, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużnej min.110N, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro poprzecznej min.62N, chłonność 400%, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Zadanie nr 5 poz.1 i 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu udokumentowania parametru czasu utrzymania ładunku powyżej 0,1sek, z uwagi na fakt, iż gdyż żadna z norm wymagana w zakresie materiałów obłożeniowych na terenie RP nie odnosi się do takowego parametru.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **ZESTAW 6**

##### **Pytania dotyczą zadania nr 1**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego wymagania SIWZ, jednakże nie zawierającego taśmy samoprzylepnej 9x49 cm i z serwetą Mayo wzmocnioną chłonną hydrofilową włókniną?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego wymagania SIWZ, w którym serweta Mayo jest wzmocniona chłonną hydrofilową włókniną?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym serweta ekran anestezjologiczny ma wymiar 140x240 cm, serweta Mayo jest wzmocniona chłonną hydrofilową włókniną, a taśma samoprzylepna ma wymiar 9x25 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### **Pytanie dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74,2 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 499%, w którym taśma samoprzylepna ma wymiar 9x50 cm? Pakowany w opakowanie transportowe karton/folia.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW 7**

##### **Dotyczy zadania nr 6 pozycja nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w zapisie SIWZ. Wg naszej wiedzy, używane przez Państwa mikroskopy/ OPMI VARIO oraz SOM 62 MOT są wyposażone w soczewkę o średnicy 65mm. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje pasującej na w/w mikroskopy osłony wykonanej z mocnej sterylnej folii wyposażona w otwór na obiektyw o średnicy 65mm, wyposażoną w wypukłą soczewkę, w trzy odprowadzenia na podglądy oraz min 2 szt. taśm lepnych, długość: 250 cm - 270 cm szer 110 cm - 120 cm ?

Uzyskana informacja umożliwi nam złożenie adekwatnej do Państwa oczekiwań oferty korzystnej zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, i jednocześnie nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

#### **Dotyczy zadania nr 6**

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ prosimy o określenie, czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia próbek jako integralnej części oferty ?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga dołączenia próbek do zadania nr 6.**

### **ZESTAW 8**

#### **Zapytanie I - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet pakowanego w opakowanie folia – folia jako bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne w transporcie a które w równym stopniu umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**


#### **Zapytanie II - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 :**

Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu uniwersalnego trzywarstwowego do długich zabiegów o gramaturze 80,20 g/m<sup>2</sup>. dodatkowo w strefie krytycznej posiadającego czwartą warstwę - wzmocnienie o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, natomiast strefa brzegowa serwet jest dwuwarstwowa i ma gramaturę 60 g/m<sup>2</sup>. Zestawu serwet pakowany jest w opakowanie folia – folia jako bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne w transporcie a które w równym stopniu umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu. Metoda sterylizacji radiacyjna. Serweta na stolik mayo rozmiar 79x145cm, taśma lepna 9x49cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

#### **Zapytanie III - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 5 :**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu Nr 5 poz. 1 zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:





1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x290 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów z możliwością regulacji otworu, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu ...	230x290	1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną .....	50x50	4
3. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
4. ręczniki chłonne .....	18x25	2
5. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Zestaw wykonany z trójwarstwowego laminatu o gram. min. 70 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetrację płynów min. 100 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro min. 163 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie na sucho min. 87N i na mokro min. 64N?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu Nr 5 poz. 2 zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:



1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240x180 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonna wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów .....	240x180	1
2. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia headrestu .....	45x60	2
3. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
4. ręczniki chłonne .....	30x40	2
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....	2x15x30	1
6. kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....	30x30	1
7. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x200	1

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gram. min. 63 g/m<sup>2</sup> a w strefie krytycznej wyrobu 83 g/m<sup>2</sup>, odporności na penetrację płynów min. 347 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej, wytrzymałości na rozrywanie na sucho min. 180 kPa i mokro min. 158 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie na sucho wzdłużnie min. 143N, poprzecznie min. 55N i na mokro wzdłużnie min. 114N i poprzecznie min. 52N?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzania spełnienia dla poz. 1, 2 parametru obciążeń nie gromadzących ładunków elektrostatycznych, tj. czasu utrzymywania ładunku poniżej 0,1 sek. ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązującą na terenie Polski.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Zapytanie IV - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 6 :**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu Nr 6 poz. 4 asortymentu pakowanego w opakowanie folia – folia jako bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne w transporcie a które w równym stopniu umożliwia łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nim asortymentu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 6 poz.4 zaproponowane rozwiązanie.**

**Powyższe zmiany zostały naniesiona w Załączniku nr 1.1 oraz 1.2 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**p.o.DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego  
*Małgorzata Usielska***