



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/21/W2/2016

Data:
27.04.2016 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/21/2016, pn. Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 12

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pytanie do pakietu 11

Prosimy o dopuszczenie zestawu do dializy dwukanałowej (dwuświatłowej) renomowanej firmy Arrow, według następującego opisu :

- cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm,
- prowadnik J ,035" x 60 cm,
- rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika
- igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm,
- zakrętki luer-lock

Zestaw ponadto zawiera strzykawkę 5ml oraz skrzydełka mocujące.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie do pakietu 12

Prosimy o dopuszczenie Zestawu do dializy dwukanałowej (dwuświatłowej) renomowanej firmy Arrow, według następującego opisu:

- cewnik dwukanałowy 12 F x16 cm,
- prowadnik J ,035" x 60 cm
- rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika
- igła punkcyjna prosta 18 G x 6,35 cm,



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

- zakrętki luer-lock
- bez ostrza

Zestaw ponadto zawiera strzykawkę 5ml oraz skrzydełka mocujące.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie do pakietu 13

Prosimy o dopuszczenie zestawu do dializy dwukanałowej (dwuświatłowej) renomowanej firmy Arrow, według następującego opisu:

- cewnik dwukanałowy pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną: w skład, której wchodzi sulfiadazylna srebra oraz chlorcheksydyna 12 F x 20 cm,
- prowadnik J ,035" x długość 60 cm,
- rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika
- igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm,
- zakrętki luer-lock,
- ostrze

W zestawie ponadto: strzykawka z otworem w tłoku 5ml, skrzydełka mocujące, igła do kontroli ciśnienia, gazik oraz dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli 20Ga/6,35cm

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie do pakietu 14

Prosimy o dopuszczenie zestawu do dializy dwukanałowej renomowanej firmy Arrow, według następującego opisu :

- cewnik pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną: w skład, której wchodzi sulfiadazylna srebra oraz chlorcheksydyna 12 F x 16 cm,
- prowadnik J ,035" długość 60 cm
- rozszerzacz w ilości 1 sztuka, w kształcie, który umożliwia takie poszerzenia otworu, że nie ma konieczności stosowania 2 rozszerzadeł o różnych średnicach, dodatkowo, średnica rozszerzadła jest dopasowana do średnicy cewnika
- igła punkcyjna prosta 18 G x 6,35 cm,
- 2 zakrętki luer-lock
- ostrze

W zestawie ponadto: strzykawka z otworem w tłoku 5ml, skrzydełka mocujące, igła do kontroli ciśnienia, skalpel, gazik oraz dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli 20Ga/6,35cm.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie do zadania 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika permanentnego zakładanego metodą tunelizacji do przodu/ antegrade do dializy renomowanej firmy Arrow według następującego opisu:

W poz. 1 cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 15 F , część dystalna cewnika stopniowana, całkowita długość cewnika do 28 cm, długość od mufki do końca cewnika - 23 cm:

o przekroju podwójne D z - igła prosta, z poliuretanu, odporny na alkoholowe środki dezynfekcyjne

- dilatator,
- przewodnik,
- przewodnik rozdzielalny (osłona prowadząca z zaworem)
- tunelizator,

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W poz. 2 cewnika permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 15 FR , część dystalna cewnika stopniowana całkowita długość cewnika 32 cm, długość od mufki do końca cewnika – 27 cm:

o przekroju podwójne D z poliuretanu, odporny na alkoholowe środki dezynfekcyjne

- igła prosta,
- dilatator,
- przewodnik,
- przewodnik rozdzielalny (osłona prowadząca z zaworem)
- tunelizator,

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Pytanie do zadania 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika permanentnego zakładanego zakładanego metodą tunelizacji do przodu/ antegrade do dializ renowowanej firmy Arrow końcówka SPLIT w kształcie litery „V” (rozdzielalny) z Carbothanu według następującego opisu:

poz. 1 Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 15 F x 32-33 cm, końcówka stopniowana, długość od mufki do końca cewnika - 27 cm,

- 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga
- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora
- 1 przewodnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywne końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej prosta
- 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka
- zaciski cewnika
- 1 kartę identyfikacyjną pacjenta

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poz. 2 Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 15 F x 28 cm, końcówka stopniowana, długość od mufki do końca cewnika - 23 cm,

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka

zaciski cewnika

1 kartę identyfikacyjną pacjenta

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poz. 3 Cewnik permanentny dwukanałowy (2-światłowy) 15 F x 36 cm, końcówka stopniowana, długość od mufki do końca cewnika - 31 cm,

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony –końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka

zaciski cewnika

1 kartę identyfikacyjną pacjenta

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Pytanie do zadania 17

Prosimy o dopuszczenie cewnika permanentnego dwukanałowego (2-światłowego) renomowanej marki Arrow, zakładanego metodą tunelizacji do przodu/ antegrade końcówka SPLIT w kształcie litery „V” do dializy renomowanej firmy Arrow według następującego opisu:

Poz.1. Cewnik dwukanałowy 15 F x 32-33 cm długość od mufki cewnika do końca 27 cm

Każdy zestaw zawiera:

- 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga
- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora
- 1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej prosta
- 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka
- zaciski cewnika

kartę identyfikacyjną pacjenta

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poz.2. Cewnik dwukanałowy 15 F x _{28cm} długość od mufki cewnika do końca 23 cm

Każdy zestaw zawiera:

- 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga
- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora
- 1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej prosta
- 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka
- zaciski cewnika
- 1 kartę identyfikacyjną pacjenta

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Pytanie do zadania 18 Prosimy o dopuszczenie cewnik permanentnego dwukanałowego (2-

światłowego) renomowanej firmy Arrow o zakładanego metodą tunelizacji do tyłu/ retrograde do dializ 15 F x 55 cm, według następującego opisu,

całkowita długość cewnika 55 cm, długość od mufki do końca cewnika 50 cm:

Zestaw zawiera:

1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.

1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr

1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie

1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

1: zespół rozgałęziacza

2: koreczki Luer-Lock

1: rozszerzadło tunelizacyjne

1: rozszerzało tkankowe 12 Fr

1: rozszerzało tkankowe 14 Fr

1: mankiet uszczelniający

1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek

1: zacisk cewnika

1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm

1: skalpel wysuwany

1: pojemnik na igły

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie do zadania 21

Prosimy o dopuszczenie zestawów do dializy dwukanałowej (dwuświatłowej)

W poz. 1

- cewnik dwukanałowy 12 F x 16 cm,

- prowadnik J ,035" x 60 cm

- rozsierzacz 10 F – 12 F,

- igła prosta 18 G x 6,35 cm,

- zakrętki luer-lock

- z poliuretanu, nie silikonowany

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W poz. 2

-cewnik dwukanałowy 12F 20 cm

-prowadnik J ,035" x 60 cm,

-rozsierzacz 10 F-12 F,

- igła prosta 18G x 6,35 cm,
- zakrętki luer-lock
- z poliuretanu nie silikonowany

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W poz. 3

- cewnik dwukanałowy 12F x 25cm
- przewód J ,035" x 60 cm
- rozszerzacz 10 F – 12 F,
- igła prosta 18 G x 6,35 cm,
- zakrętki luer-lock
- z poliuretanu, nie silikonowany

Każdy zestaw ponadto zawiera strzykawkę 5ml oraz skrzydełka mocujące.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. Wzoru umowy:

1. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §1 ust. 6 wzoru umowy zastrzeżenia, że zmniejszenie ilości dostaw przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wartości umowy.
2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
3. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej określonej w §3 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości dostarczonej ze zwłoką części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do równowartości różnicy cen towarów.
5. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w par. 3 ust. 3 do 0,2% reklamowanego towaru.
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 4 poprzez naliczanie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
7. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1/ stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
- 2/ powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3, § 3 ust. 3 umowy;
- 3/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z istotnymi wadami jakościowymi;
- 4/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;
- 5/ wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu dla oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
- 6/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.”

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

ZESTAW 15

1.Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści zestaw do dializy dwukanałowej, zawierający nitinolowy przewód J 0,89 x 70 cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści zestaw do dializy dwukanałowej, zawierający nitinolowy przewodnik J 0,89 x 70 cm oraz dołączone do zestawu ostrze (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 zad. 1 dopuści permanentny cewnik dwukanałowy 15F, o długości od mufki do końca cewnika- 23cm i długości całkowitej 40cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 zad. 2 dopuści permanentny cewnik dwukanałowy 15 F, o długości od mufki do końca cewnika- 28 cm i długości całkowitej 45 cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Czy zamawiający w pakiecie nr 16 zad. 1,2 i 3 dopuści cewnik permanentny dwukanałowy 15 F, o opatentowanej, zapobiegającej zakrzepianiu końcówce hemodynamicznej (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


6. Czy zamawiający w zadaniu nr 17 zad. 1 dopuści cewnik permanentny dwukanałowy 15 F, dł. od mufki do końca cewnika 28 cm, posiadający unikalną, opatentowaną, zapobiegającą zakrzepianiu końcówkę hemodynamiczną (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

0000 T-Mobile.pl 30

17:52
joano.de

10%

ien LT Anterograde — Long Term

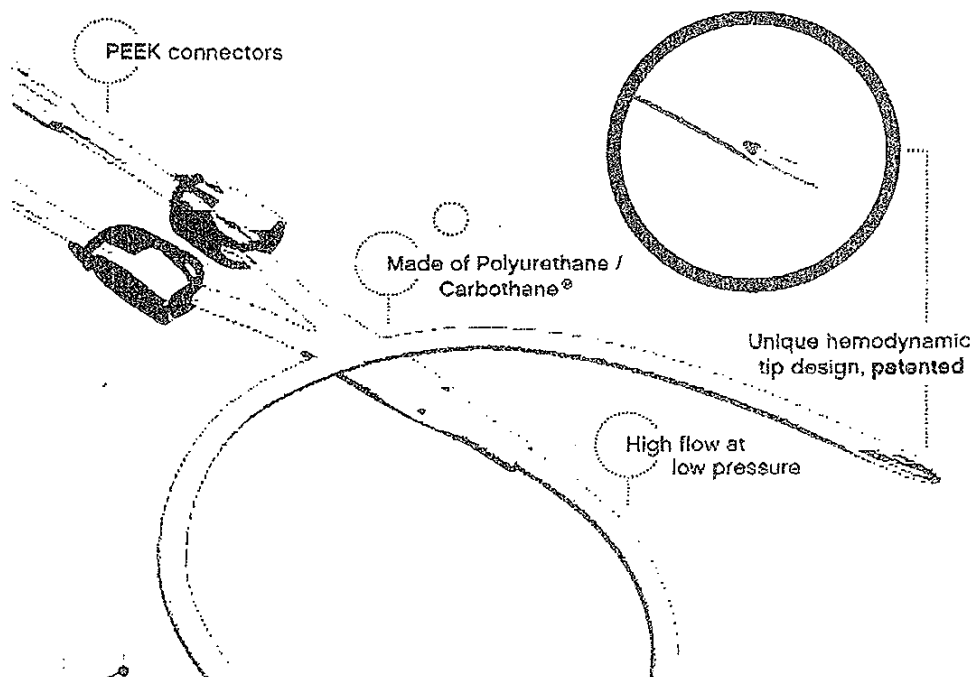

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Czy zamawiający w zadaniu nr 17 zad. 2 dopuści cewnik permanentny dwukanałowy 15 F, posiadający unikalną, opatentowaną, zapobiegającą zakrzepianiu końcówkę hemodynamiczną (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 16

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści zestaw do dializy dwukanałowej, zawierający prowadnik J 0,35 x 50 cm oraz dołączone do zestawu implantacyjnego ostrze (pozostałe parametry zgodne z SIWZ) ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska