



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/52/2016/1

Data:
26.07.2016 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/52/2016, pn. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii, linii krwi, filtrów do nerek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 5, dopuści złożenie oferty z liniami krwi do aparatów Gambro, zgodnymi z poniższym schematem, w pełni kompatybilnymi z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami?

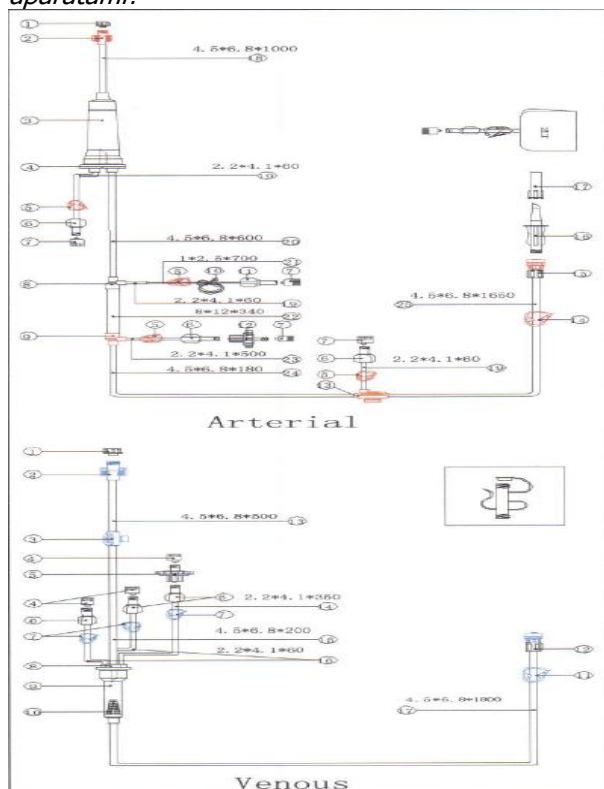

**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 2

Pytanie dotyczące zadania nr 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika do mapingu żył płucnych o długości użytkowej 110 cm z 5 średnicami pętli w zakresie 12-24 mm.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie dotyczące zadania nr 1,2,4

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietów 4 i 5 cewników dla pacjentów pediatrycznych

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na linie krwi o nowoczesnej i unikatowej konstrukcji do aparatu Gambro AK, która umożliwi łatwe i proste zakładanie ich na pompę i nie wymaga stosowania dodatkowych łączników (poprzeczek) segmentu pompy krwi i posiadające worek o pojemności 2 litrów, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 4, 5 i 6

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym z zachowaniem terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie w oparciu o w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:

- **termin składania ofert** – 28.07.2016 r., do godz. 08 : 00 **na 02.08.2016 r. do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert** – 28.07.2016 r. godz. 8:30 **na 02.08.2016 r. o godzinie 8:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy:

- **w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 02.08.2016 r. do godz. 08:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2016 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ul. Arkońskiej 4”.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska